Ortino

Orthosis Innovation

راهنمای استفاده از

Malleow FootBrace



ISO 9001: 2015 Quality Management

ISO 13485 : 2016 Medical Devices

GMP Good Manufacturing Practices

BRS Standards Certification Body

CE Quality Certification

Certificate IMED

Malleow Foot Brace | مچ‌بند مالئو


Ortino

۱



ابتدا قرقره را به سمت جلو بکشید تا آزاد شود و نخ‌ها را باز کنید.


۲

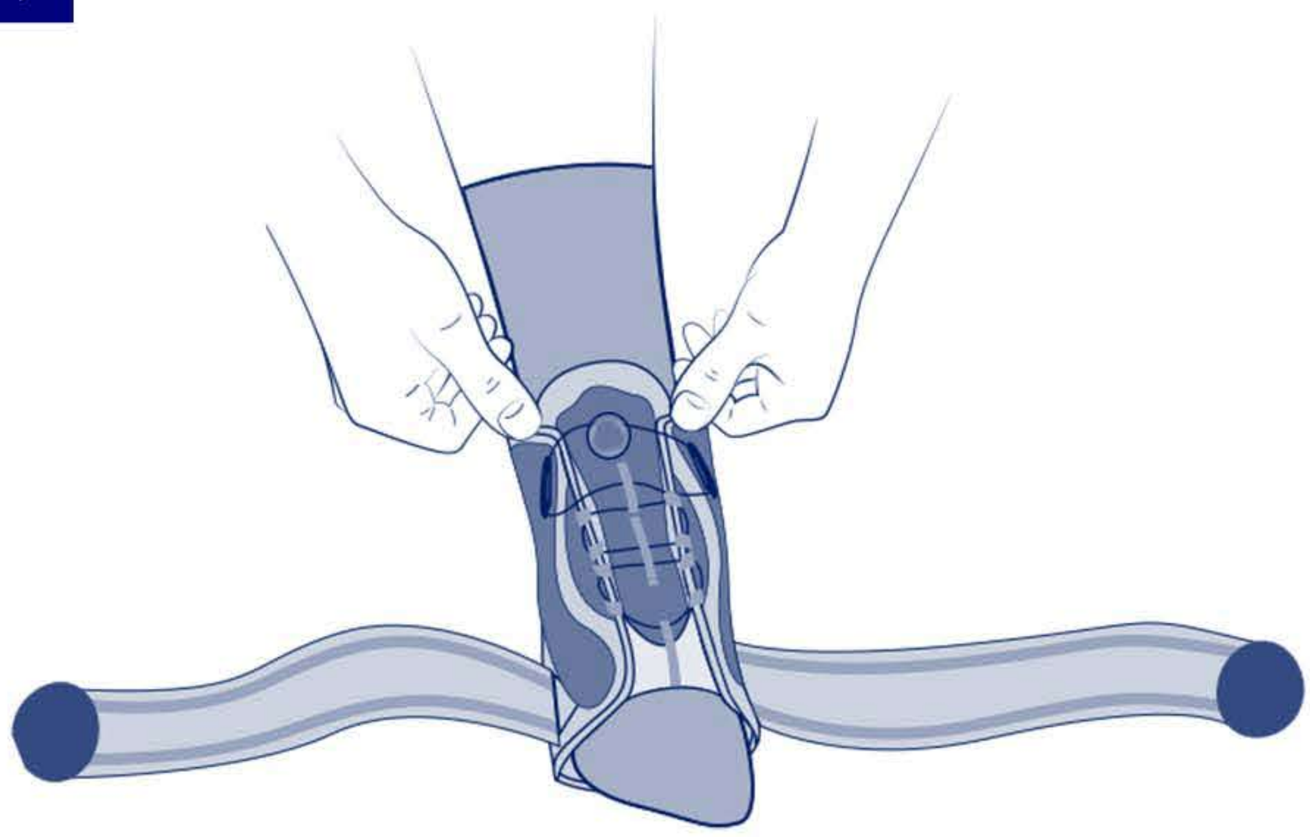

مچ بند را بپوشید بطوریکه پاشنه پا به درستی در تکیه گاه قرار گیرد.


۳




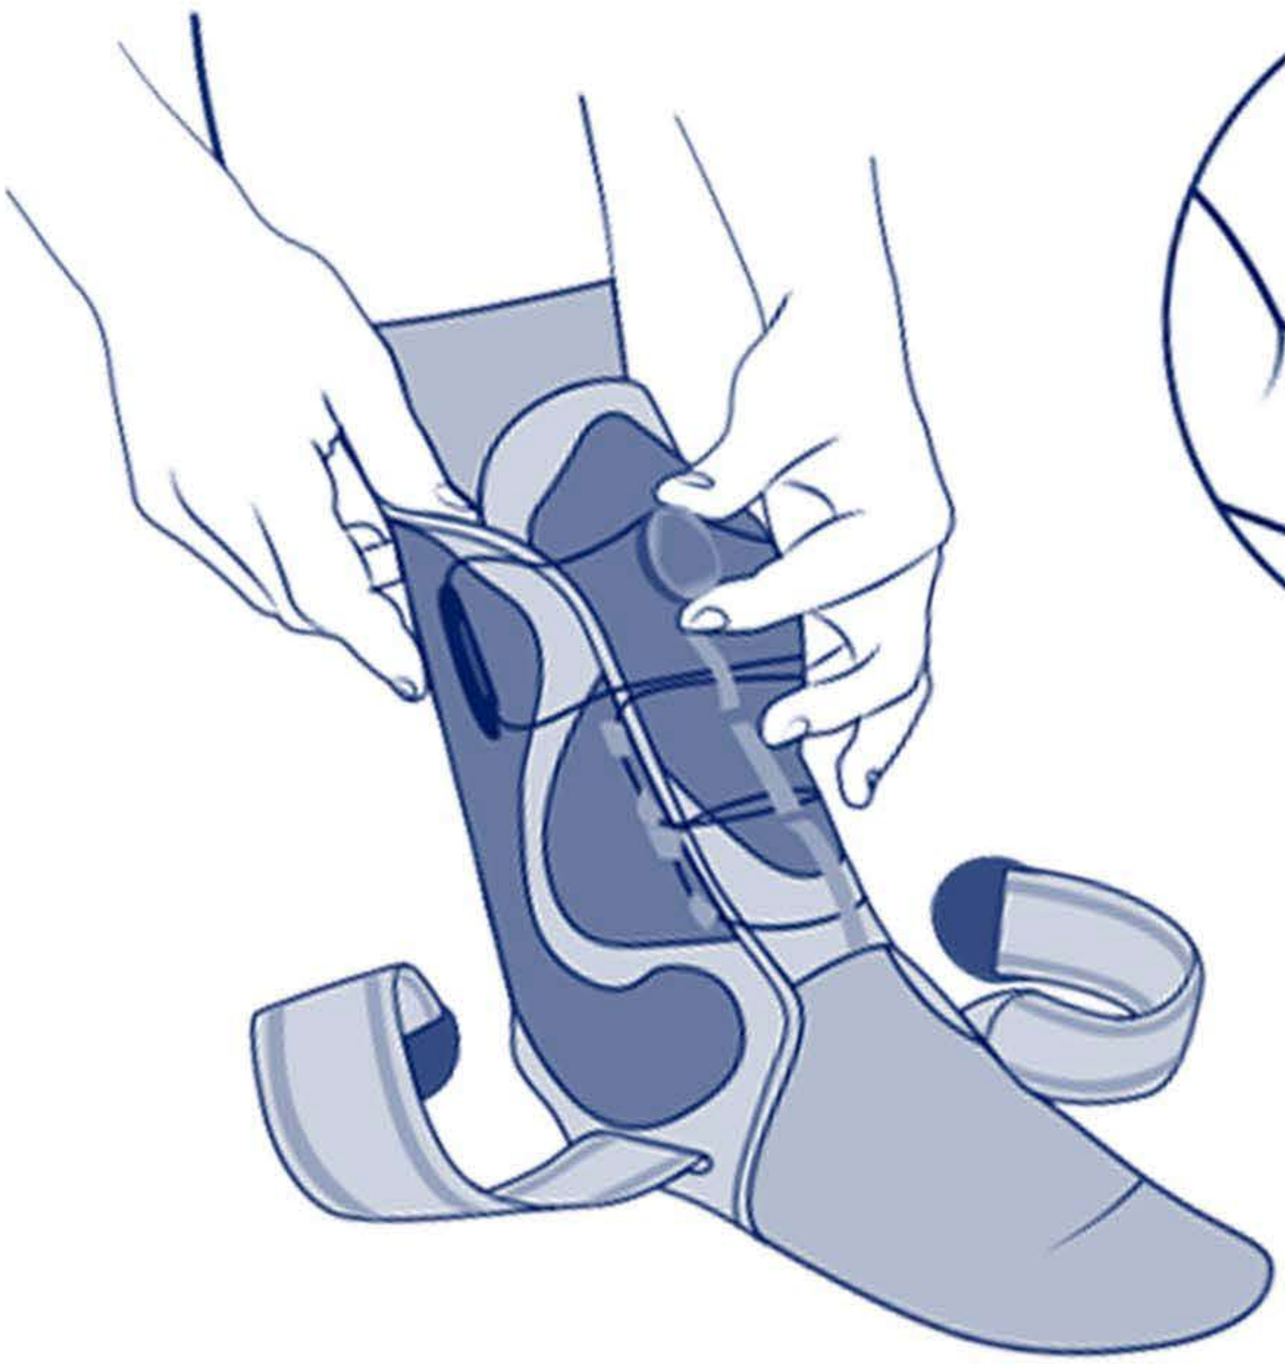

قرقره را به داخل فشار داده و بصورت ساعتگرد بچرخانید تا نخ ها جمع شوند.

۴

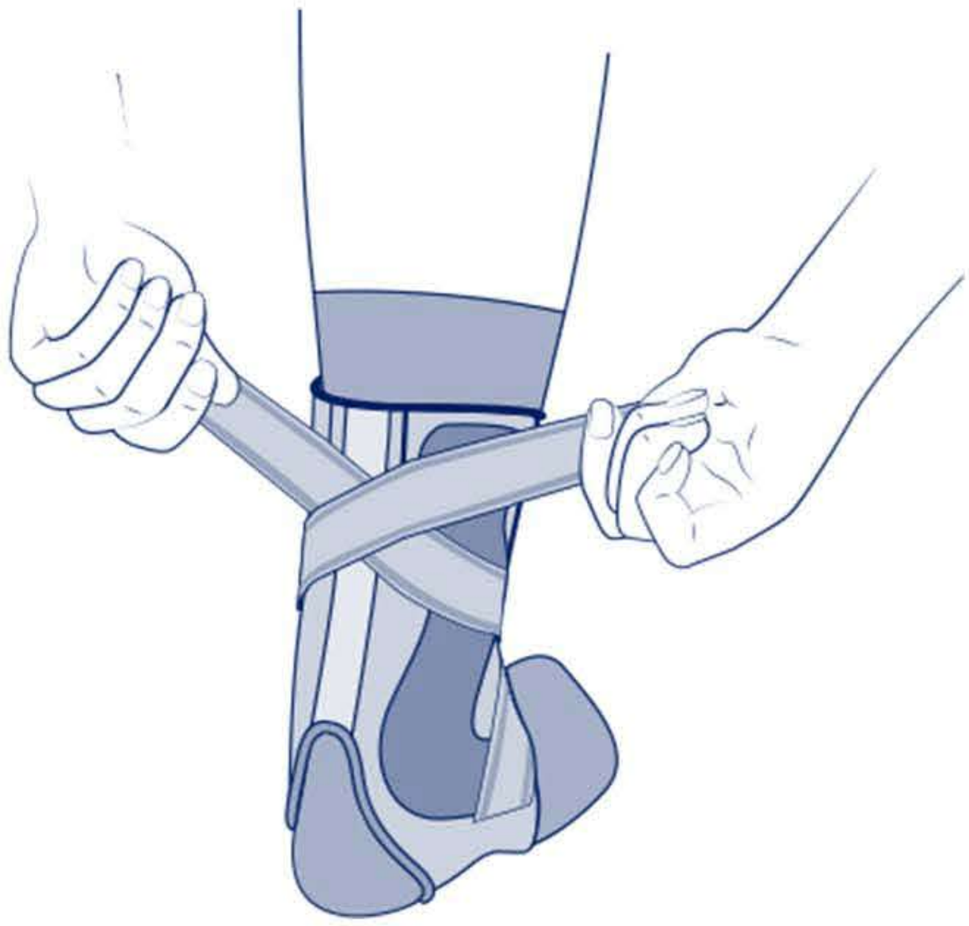

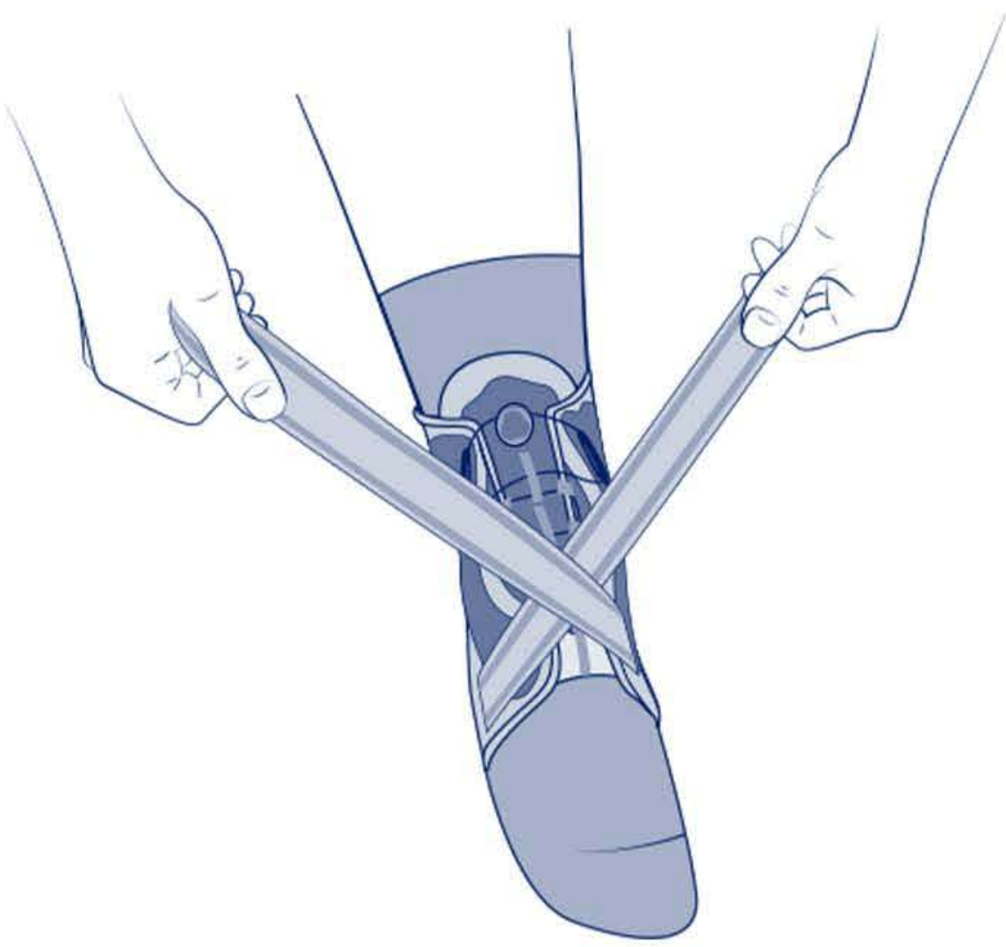

کش‌ها را بکشید و بصورت ضربدری از پشت مچ بند عبور داده و به کنار آن بچسبانید.


۵

شما می توانید با کشیدن قرقره به جلو، نخ ها را شل نموده و محصول را باز کنید.






۶

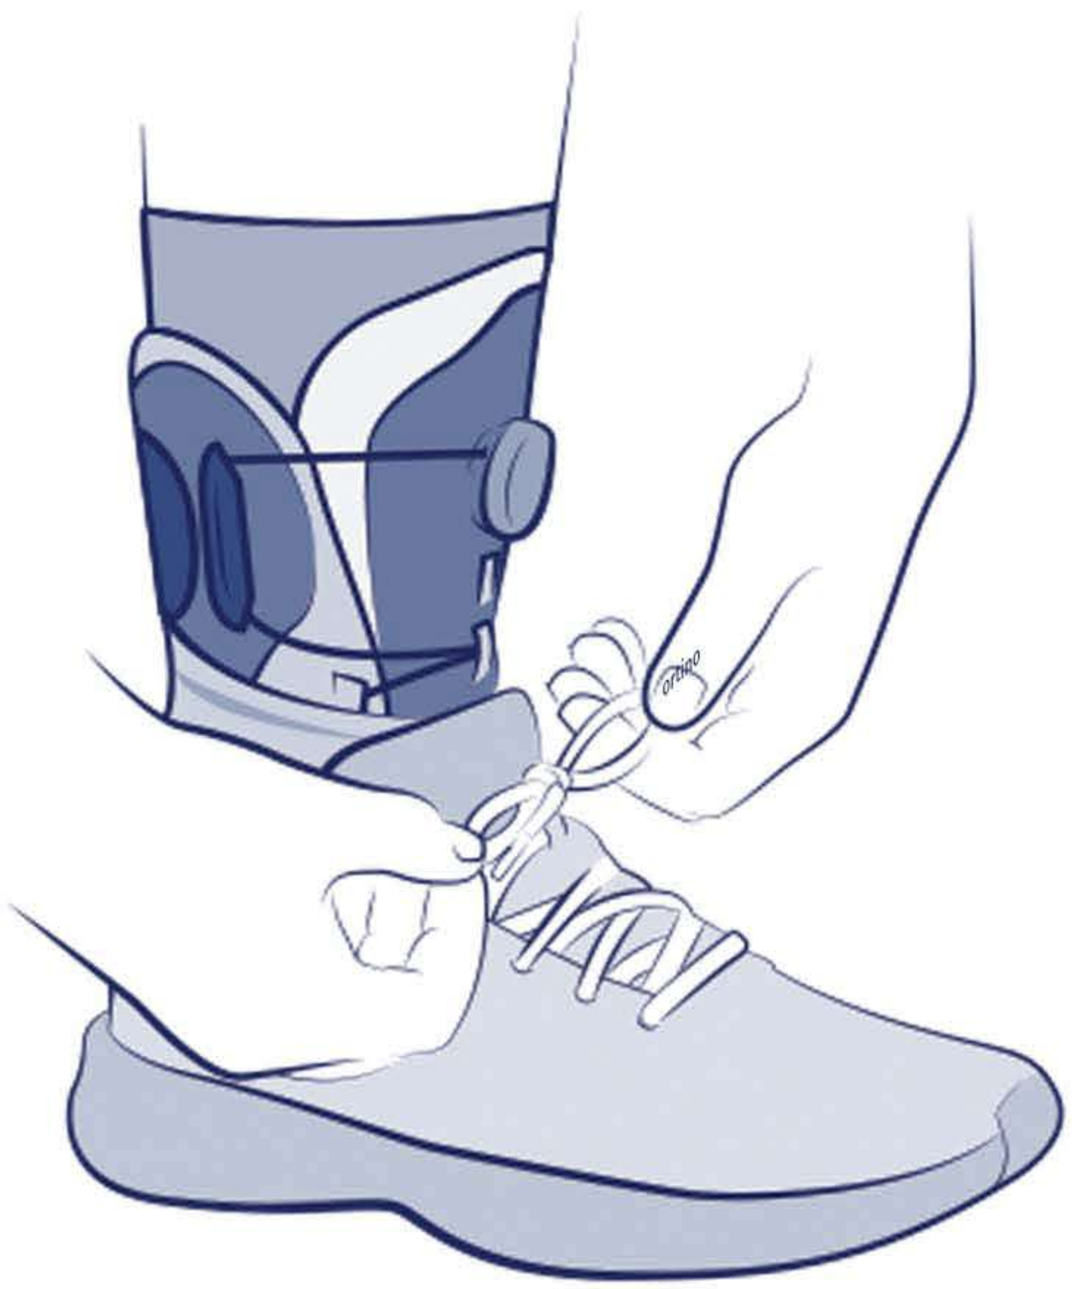

شما می توانید از این مچ بند در داخل کفش نیز استفاده کنید.

۷

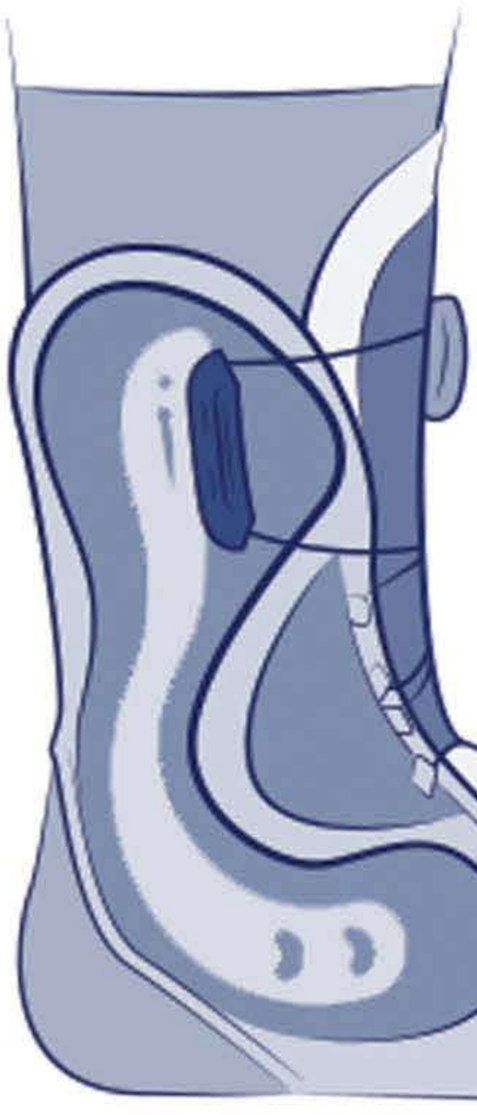

در صورت ایجاد هرگونه ناراحتی در ناحیه استخوان مچ پا، می‌توانید موقعیت آتل‌ها را تغییر داده یا آنها را بردارید:
چسب‌های ولکرو (در ناحیه کناری مچ بند) را باز کنید و آتل ها را به آرامی دربیاورید.